

POTWIERDZENIE MONTAŻU SZAFKI ROTAID I PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zgodnie z Umową nr **38/WZ/2022-51142** dnia **26.09.2022** zamontowano szafkę Rotaïd Outdoor. Prawidłowość zamontowanej szafki potwierdzono protokołem odbioru. Szafka zamontowana zgodnie z miejscem wskazanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na miejscu montażu.


Defibrylator AED SAMARITAN PAD 350P wraz z dokumentami, instrukcją obsługi, gwarancją, torbą, baterią /elektrodami PAD PAK oraz setem ratunkowym został przekazany osobie upoważnionej. Zaleca się niezwłoczne umieszczenie baterii i elektrod w AED oraz umieszczenie AED wewnątrz kapsuły. W przypadku użycia - prosimy kontakt z naszą firmą.



Urządzenie w tej lokalizacji zostało przewieszone ze względu na zmianę miejsca z wewnątrz na ścianę zewnętrzną.

MIEJSCJE MONTAŻU

Szkoła Podstawowa nr. 3
Ulica Sosnowa 16
KONIN

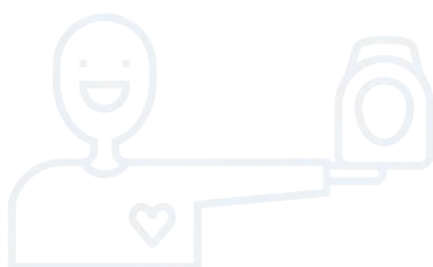

POTWIERDZENIE MONTAŻU SZAFKI ROTAID I PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zgodnie z Umową nr **38/WZ/2022-51142** dnia **26.09.2022** zamontowano szafkę Rotaïd Outdoor. Prawidłowość zamontowanej szafki potwierdzono protokołem odbioru.


Szafka zamontowana zgodnie z miejscem wskazanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na miejscu montażu.

Defibrylator AED SAMARITAN PAD 350P wraz z dokumentami, instrukcją obsługi, gwarancją, torbą, baterią /elektrodami PAD PAK oraz setem ratunkowym został przekazany osobie upoważnionej. Zaleca się niezwłoczne umieszczenie baterii i elektrod w AED oraz umieszczenie AED wewnątrz kapsuły. W przypadku użycia - prosimy kontakt z naszą firmą.



MIEJSCJE MONTAŻU

Szkoła Podstawowa nr. 9
Ulica FIKUSOWA9
KONIN

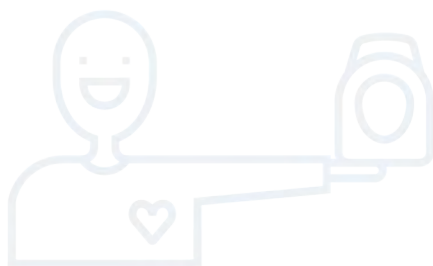

POTWIERDZENIE MONTAŻU SZAFKI ROTAID I PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zgodnie z Umową nr **38/WZ/2022-51142** dnia **26.09.2022** zamontowano szafkę RotaId Outdoor. Prawidłowość zamontowanej szafki potwierdzono protokołem odbioru. Szafka zamontowana zgodnie z miejscem wskazanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na miejscu montażu.

Defibrylator AED SAMARITAN PAD 350P wraz z dokumentami, instrukcją obsługi, gwarancją, torbą, baterią /elektrodami PAD PAK oraz setem ratunkowym został przekazany osobie upoważnionej. Zaleca się niezwłoczne umieszczenie baterii i elektrod w AED oraz umieszczenie AED wewnątrz kapsuły. W przypadku użycia - prosimy kontakt z naszą firmą.



MIEJSCJE MONTAŻU

Szkoła Podstawowa nr.11
Ulica ŁĘŻYŃSKA 9
KONIN

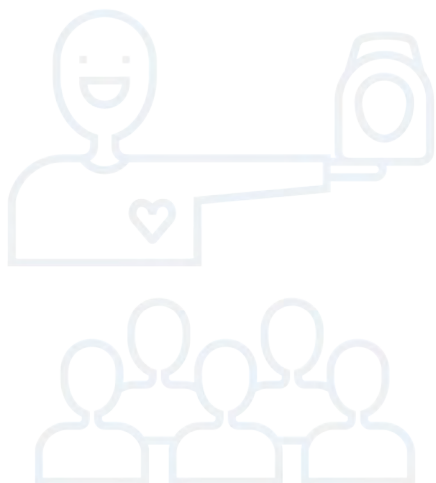

POTWIERDZENIE MONTAŻU SZAFKI ROTAID I PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zgodnie z Umową nr **38/WZ/2022-51142** dnia **26.09.2022** zamontowano szafkę Rotaid Outdoor.

Prawidłowość zamontowanej szafki potwierdzono protokołem odbioru.

Szafka zamontowana zgodnie z miejscem wskazanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na miejscu montażu.


Defibrylator AED SAMARITAN PAD 350P wraz z dokumentami, instrukcją obsługi, gwarancją, torbą, baterią /elektrodami PAD PAK oraz setem ratunkowym został przekazany osobie upoważnionej. Zaleca się niezwłoczne umieszczenie baterii i elektrod w AED oraz umieszczenie AED wewnątrz kapsuły.

W przypadku użycia - prosimy kontakt z naszą firmą.



MIEJSCJE MONTAŻU

**COP CENTRUM
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Ul. 3 Maja 13, KONIN**

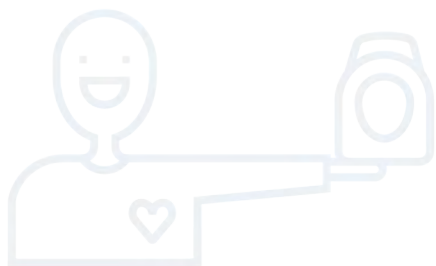


POTWIERDZENIE MONTAŻU SZAFKI ROTAID I PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zgodnie z Umową nr **38/WZ/2022-51142** dnia **26.09.2022** zamontowano szafkę Rotaid Outdoor. Prawidłowość zamontowanej szafki potwierdzono protokołem odbioru. Szafka zamontowana zgodnie z miejscem wskazanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na miejscu montażu. Defibrylator AED SAMARITAN PAD 350P wraz z dokumentami, instrukcją obsługi, gwarancją, torbą, baterią /elektrodami PAD PAK oraz setem ratunkowym został przekazany osobie upoważnionej. Zaleca się niezwłoczne umieszczenie baterii i elektrod w AED oraz umieszczenie AED wewnątrz kapsuły. W przypadku użycia - prosimy kontakt z naszą firmą.



MIEJSCJE MONTAŻU

**BIBLIOTEKA UL.
Gostawicka 46
KONIN**

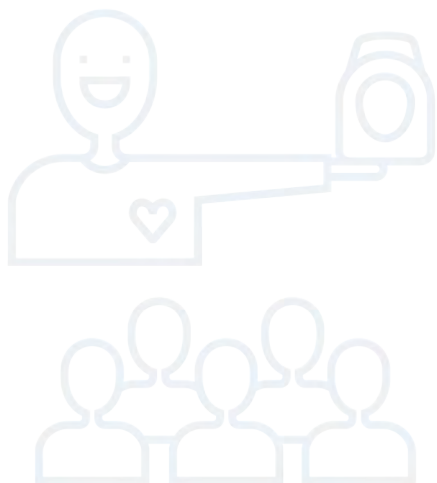

POTWIERDZENIE MONTAŻU SZAFKI ROTAID I PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zgodnie z Umową nr **38/WZ/2022-51142** dnia **26.09.2022** zamontowano szafkę RotaId Outdoor. Prawidłowość zamontowanej szafki potwierdzono protokołem odbioru. Szafka zamontowana zgodnie z miejscem wskazanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na miejscu montażu.

Defibrylator AED SAMARITAN PAD 350P wraz z dokumentami, instrukcją obsługi, gwarancją, torbą, baterią /elektrodami PAD PAK oraz setem ratunkowym został przekazany osobie upoważnionej. Zaleca się niezwłoczne umieszczenie baterii i elektrod w AED oraz umieszczenie AED wewnątrz kapsuły. W przypadku użycia - prosimy kontakt z naszą firmą.



MIEJSCJE MONTAŻU

Basen sportowy
kryty MOSIR
KONIN

